


FICHE TECHNIQUE: Logiciel « potentiel de repos et potentiel d'action »

Lien : <http://viasvt.fr/potentiel-action/propagation-pa.html>

Potentiel de repos de la fibre nerveuse

Le dispositif constitué d'un oscilloscope amplificateur et de deux électrodes permet d'enregistrer l'état électrique d'une fibre nerveuse isolée au repos. La microélectrode de mesure, reliée au fil rouge, peut être implantée dans l'axone. Que constate-t-on ?

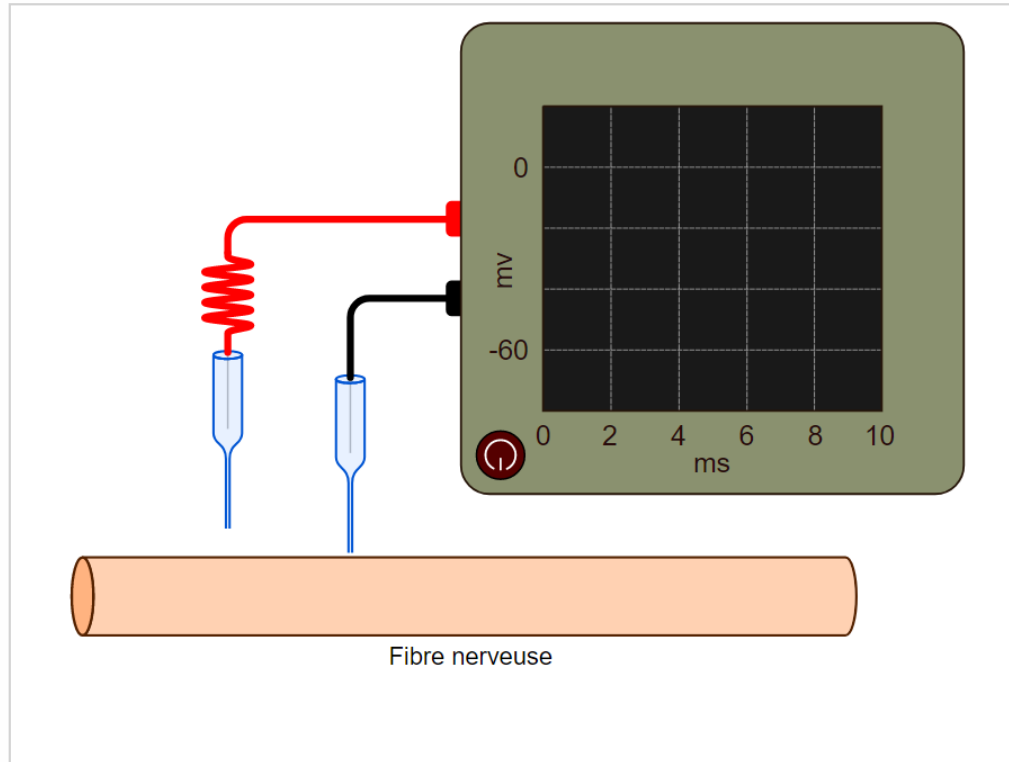

← Consignes à suivre

← Passage en plein écran

← Onglets permettant d'accéder au différentes pages